

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 492/BC-TTYT

Đồng Xoài, ngày 07 tháng 08 năm 2020.

V/v: Báo cáo hiện trạng máy chụp
X-Quang tại TTYT thành phố.

Kính gửi: UBND thành phố Đồng Xoài.

Căn cứ Công văn số 1949/STC-GCS ngày 21/7/2020 của Sở Tài chính về việc mua sắm trang thiết bị tại TTYT thành phố Đồng Xoài;

Căn cứ Công văn số 1559/UBND-KT ngày 27/7/2020 của UBND thành phố Đồng Xoài V/v khẩn trương kiểm tra, báo cáo hiện trạng máy X-Quang tại Trung tâm y tế thành phố,

Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài báo cáo như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 29 tháng 7 năm 2020 các đơn vị: phòng TC-KH, phòng Kinh tế, phòng Y tế thành phố đã phối hợp cùng Trung tâm y tế thành phố tiến hành kiểm tra hiện trạng máy chụp X-Quang đang sử dụng tại Trung tâm y tế thành phố, kết quả:

Máy chụp X-Quang đang sử dụng tại trung tâm y tế thành phố có hiệu Kelex MD 1100 bằng cơ, rửa phim bằng tay trong phòng tối. Máy được mua và đưa vào sử dụng năm 2016 từ nguồn kinh phí kết dư bảo hiểm y tế với nguyên giá 400.521.172đ (Bốn trăm triệu, năm trăm hai một ngàn, một trăm bảy hai đồng).

Máy chụp X-Quang được sử dụng từ năm 2016 đến nay, tuy nhiên từ năm 2019, máy thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa. Qua kiểm tra hiện trạng, máy không hoạt động. (kèm theo biên bản kiểm tra hiện trạng)

Máy chụp X-Quang hiệu Kelex MD 1100 là máy thuộc thế hệ cũ, hiệu quả hoạt động không cao, hiện nay đã hư hỏng. Qua buổi làm việc, các thành phần tham gia kiểm tra thống nhất đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho Trung tâm Y tế thành phố mua máy chụp X-Quang kỹ thuật số từ nguồn ngân sách thành phố đã được giao cho Trung tâm y tế thành phố trong dự toán năm 2020.

Trung tâm y tế thành phố báo cáo UBND thành phố xem xét.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH, phòng Kinh tế,
- Phòng Y tế thành phố;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



BSCRI. Trịnh Xuân Thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG MÁY CHỤP XQUANG

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2020. Tại Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài đã tiến hành kiểm tra hiện trạng máy Xquang.

I. Thành phần:

1. Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đồng Xoài:

- Bà: Đỗ Thị Phương Cúc - Phó trưởng phòng.
- Bà: Đỗ Thị Thu Hiền - Chuyên viên.

2. Đại diện Phòng Kinh tế thành phố Đồng Xoài:

- Ông: Phạm Ngọc Hoàn - Phó trưởng phòng.

3. Đại diện Phòng Y tế thành phố Đồng Xoài:

- Bà: Phạm Thị Kim Loan – Trưởng phòng.

4. Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài:

- Ông: Trịnh Xuân Thiệu - Giám đốc.
- Bà: Nguyễn Thị Hằng Nga - Phụ trách kế toán.

II. NỘI DUNG: Kiểm tra hiện trạng máy chụp Xquang, cụ thể như sau:

1. Nguồn gốc, hiện trạng tài sản:

Máy chụp X- Quang đang sử dụng tại trung tâm y tế thành phố có hiệu Kelex MD 1100 bằng cơ, rửa phim bằng tay trong phòng tối. Máy được mua và đưa vào sử dụng năm 2016 từ nguồn kinh phí kết dư bảo hiểm y tế với nguyên giá 400.521.172đ (*Bốn trăm triệu, năm trăm hai một ngàn, một trăm bảy hai đồng*).

Máy chụp X-Quang được sử dụng từ năm 2016 đến nay, tuy nhiên từ năm 2019, máy thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa. Qua kiểm tra hiện trạng, máy không hoạt động.

2. Kiến nghị:


Máy chụp X-Quang hiệu Kelex MD 1100 là máy thuộc thế hệ cũ, hiệu quả hoạt động không cao, hiện nay đã hư hỏng.

Theo bảng báo giá sửa chữa máy Xquang của các Công ty thì chi phí sửa chữa máy Xquang hơn 200 triệu đồng. (Có các bảng báo giá sửa chữa kèm theo).

Qua buổi làm việc, với chi phí sửa chữa rất cao. Các thành phần tham gia kiểm tra thống nhất đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho Trung tâm Y tế thành phố mua máy chụp X-Quang kỹ thuật số từ nguồn ngân sách thành phố đã được giao cho Trung tâm y tế thành phố trong dự toán năm 2020.


Buổi làm việc kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản làm việc lập thành 04 bản, thông qua cho các bên cùng nghe và nhất trí ký tên./.

ĐD. PHÒNG Y TẾ

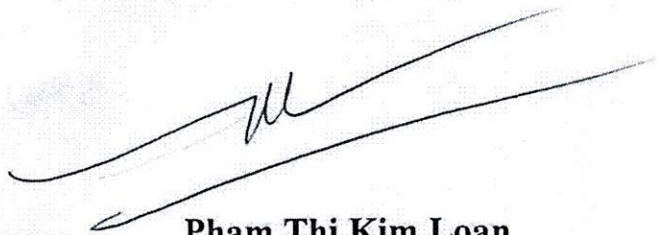


Phạm Thị Kim Loan

ĐD. TRUNG TÂM Y TẾ




Trịnh Xuân Thiều

ĐD. PHÒNG KINH TẾ

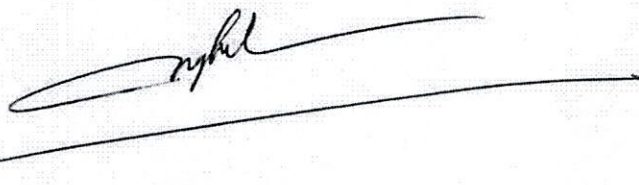


Phạm Ngọc Hoàn

ĐD. PHÒNG TC - KH

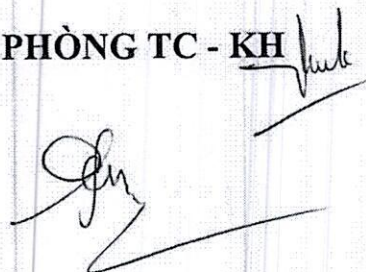

Đỗ Thị Phương Cúc



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y SINH
(Y SINH TECHNOLOGY EQUIPMENT CO., LTD).

57 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.

ĐT: 028.38161135 Fax: 028.38161165

Tp. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BẢNG BÁO GIÁ


Kính gửi: Ban Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Thành Phố Đồng Xoài

Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Y Sinh hân hạnh chào giá chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy X-Quang như sau:

STT	TÊN THIẾT BỊ- DỊCH VỤ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND)	THÀNH TIỀN (VND)
01	Thay Đầu đèn X-Quang TOSHIBA ROTANODE (Model: E 7820X) Sửa lại board Relay cần thay IC điều khiển và IC điều chỉnh thời gian	Bộ	01	220.000.000	220.000.000
TỔNG CỘNG: Hai trăm hai mươi triệu đồng.					220.000.000

- ✓ Báo giá có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký
- ✓ Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng.
- ✓ Hàng mới 100%.
- ✓ Thời hạn thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- ✓ Thời gian bảo hành: Linh kiện được bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt và nghiệm thu hợp đồng.
- ✓ Thời gian thanh toán:
 - +Đợt 1: Thanh toán 30% ngay sau khi ký hợp đồng
 - +Đợt 2: Thanh toán 70% còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị

Trân trọng kính chào.

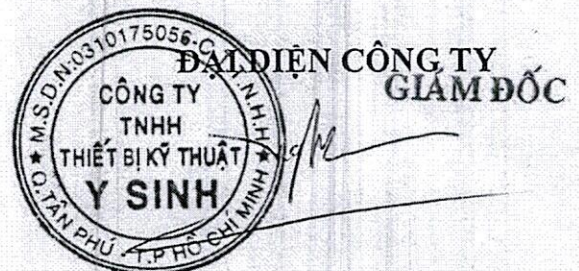

Nguyễn Thị Nguyệt

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÚC

Địa Chỉ: 473/8/12 Đường Tô Hiến Thành – Phường 14 – Quận 10 – Tp. HCM

Tel: 083.8635076 – Fax: 083.8687292

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Ban Giám Đốc Trung Tâm Y Tế Thành Phố Đồng Xoài


Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Phúc hân hạnh chào giá chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy X-Quang như sau:

STT	TÊN THIẾT BỊ- DỊCH VỤ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND)	THÀNH TIỀN (VND)
01	Thay Đầu đèn X-Quang TOSHIBA ROTANODE (Model: E 7820X) Sửa lại board Relay cần thay IC điều khiển và IC điều chỉnh thời gian	Bộ	01	224.400.000	224.400.000
TỔNG CỘNG: Hai trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng.					224.400.000

- ✓ Báo giá có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký
- ✓ Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng.
- ✓ Hàng mới 100%.
- ✓ Thời hạn thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- ✓ Thời gian bảo hành: Linh kiện được bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt và nghiệm thu hợp đồng.
- ✓ Thời gian thanh toán:
 - +Đợt 1: Thanh toán 30% ngay sau khi ký hợp đồng
 - +Đợt 2: Thanh toán 70% còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị

Trân trọng kính chào.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2020



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Khắc Chuẩn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 TP.HCM
Tel : (028) 38.685.037 – 38.644.474 Hotline: 0908.825.169
Fax : (028) 38.650.750 – 38.665.840
Email : thietbiyte.codupha@gmail.com

Tp. HCM, ngày 23 tháng 7 năm 2020

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung Tâm Y Tế Thành Phố Đồng Xoài

Chúng tôi, Công Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha hân hạnh chào giá thiết bị & vật tư theo yêu cầu của Quý Khách như sau:

STT	TÊN THIẾT BỊ- DỊCH VỤ	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ (VND)	THÀNH TIỀN (VND)
01	Thay Đầu đèn X-Quang TOSHIBA ROTANODE (Model: E 7820X) Sửa lại board Relay cần thay IC điều khiển và IC điều chỉnh thời gian	Bộ	01	231.000.000	231.000.000
TỔNG CỘNG					231.000.000

Tổng cộng (Bằng chữ): Hai trăm ba mươi một triệu đồng


- Báo giá có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại đơn vị sử dụng.
- Hàng mới 100%.
- Thời hạn thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thời gian bảo hành: Linh kiện được bảo hành 06 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt và nghiệm thu hợp đồng.
- Thời gian thanh toán:
 - Đợt 1: Thanh toán 30% ngay sau khi ký hợp đồng
 - Đợt 2: Thanh toán 70% còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu thiết bị

Trân trọng kính chào.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CODUPHA
Phó giám Đốc Kinh Doanh



Đào Minh Sơn



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y SINH
(Y SINH TECHNOLOGY EQUIPMENT CO., LTD).

57 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.

ĐT: 028.38161135 Fax: 028.38161165



BIÊN BẢN KIỂM TRA

XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN & CÁCH KHẮC PHỤC LỖI MÁY

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Tại: Trung Tâm Y Tế Thị Xã Đồng Xoài, Chúng tôi gồm:

Đại diện bên sử dụng máy: Trung Tâm Y Tế Thành Phố Đồng Xoài

1. Cán bộ QL. TTB: (Ông/Bà).....*Đường Thị Thanh*.....
2. Cán bộ kỹ thuật: (Ông/Bà).....
3. Cán bộ sử dụng thiết bị: (Ông/Bà).....*Đinh Văn Đường*.....

Đại diện bên sửa chữa máy: Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Y Sinh

1. Cán bộ kỹ thuật: (Ông). Nguyễn Đại
2.
3.

Cùng nhau xác minh tình trạng của máy: *Máy X-quang KELEX MD 1100, Thái Lan.*

Nhãn hiệu: KELEX MB 1100 Số máy: 59-01-2-01 (1/5)

I. TÌNH TRẠNG LỖI MÁY:

Máy hoạt động kém, chạy không ổn định, khó khởi động: ảnh rất mờ, chụp phim không rõ nét.

II. NGUYÊN NHÂN LỖI MÁY:

Đầu đèn X-Quang TOSHIBA ROTANODE bị mờ, chụp phim không rõ nét.
Board điều khiển Relay trong bị hỏng

III. PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA THAY THẾ:

1. Thay Đầu đèn X-Quang TOSHIBA ROTANODE (Model: E 7820X)
2. Sửa lại board Relay cần thay IC điều khiển và IC điều chỉnh thời gian

ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG MÁY

Đinh Văn Đường

ĐẠI DIỆN BÊN SỬA CHỮA MÁY

Cán bộ kỹ thuật

Nguyễn Đại

Nguyễn Đại



Ký bởi: Ủy ban nhân dân thành phố
Đông Xoài
Email: ubnd.tpdx@binhphuoc.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bình Phước
Ngày ký: 02-06-2020 09:14:09 +07:00

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG XOÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1114 /UBND-KT

Đông Xoài, ngày 02 tháng 6 năm 2020

V/v tham mưu đề xuất theo đề nghị
của Trung tâm Y tế thành phố.

Kính gửi:

- Phòng TC-KH thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố.

Xét Tờ trình số 321 /TTr-TTYT ngày 27/5/2020 của Trung tâm Y tế thành phố về việc đề nghị UBND thành phố xin chủ trương đầu tư mua máy X quang kỹ thuật số tại Trung tâm Y tế năm 2020;

Tiếp theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 581/UBND-KT ngày 30/3/2020, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng TC-KH thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố rà soát, kiểm tra hồ sơ, hiện trạng và tham mưu UBND thành phố xem xét đối với việc đề nghị mua sắm tài sản theo Tờ trình số 321 /TTr-TTYT ngày 27/5/2020 của Trung tâm Y tế thành phố, đảm bảo đúng quy định. Báo cáo UBND thành phố xem xét *trước ngày 15/6/2020*.

(có Tờ trình gửi kèm)

Yêu cầu các đơn vị nêu trên phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND thành phố;
- LĐVP, CV: KT, VX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Bình

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Thành ủy
(Phiên họp chiều ngày 04/3/2020)

Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp Thường trực Thành ủy.

Dự họp có: 03/03 đồng chí Thường trực Thành ủy.

Cùng dự có các đồng chí:

- Lãnh đạo: UBND thành phố, phòng TC-KH thành phố.
- Lãnh đạo và Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Thành ủy.

Tại cuộc họp sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo xin chủ trương thực hiện đầu tư một số công trình từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020, tại Tờ trình số 29/TTr-UBND, ngày 04/3/2020 của UBND thành phố (kèm theo danh mục đầu tư), qua bàn bạc thảo luận Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương thực hiện các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 như sau:

1. Nâng cấp, thảm nhựa một số tuyến đường khu trung tâm hành chính thành phố Đồng Xoài, từ vốn sự nghiệp giao thông do Ban QLCDTA thành phố làm chủ đầu tư.

2. Cải tạo, sửa chữa Hội trường, trụ sở làm việc, sân, đường nội bộ Trung tâm Y tế thành phố và mua máy X Quang kỹ thuật số, từ nguồn vốn sự nghiệp y tế, do Trung tâm Y tế thành phố làm chủ đầu tư.

Giao UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư theo đúng quy định và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Nơi nhận:

- UBND thành phố,
- Phòng TC-KH thành phố,
- VPTU: LĐ, CVTH,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Văn Quân